

LISA  
Lumbar Implant for Stiffness Augmentation

IMPLANTAT-KARTE  
HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

**BACK BONE International Implant Card** 

①  \_\_\_\_\_

②  \_\_\_\_\_

③  \_\_\_\_\_

④  [backbone.pro/patients-information](http://backbone.pro/patients-information)

⑤

⑥ **MD** BB-LISA-1-104 LISA Blocker

⑦ **UDI-DI** 3760248630014

⑧ **LOT** A12345

⑨ **UDI** 

en Blocker /da Lás  
fr Verrou /de Blocker  
es Bloquear /sk Blokátor  
cz Blokátor /zh 锁定  
pt Bloqueio /pl Bloker

 **BACKBONE 81 Boulevard Pierre 1er  
Le Bouscat 33110 France**

⑩

## IMPLANTAT-KARTE HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN

Von der Gesundheitseinrichtung/dem Leistungserbringer auszufüllen:

- ①  Name des Patienten oder Patienten-ID
- ②  Datum der Implantation
- ③  Name und Anschrift der Gesundheitseinrichtung/des Leistungserbringers

Die Produktinformationen der Implantat-Karte, die den Nummern 5 bis 9 entsprechen, werden in Form eines Aufklebers mit den einzelnen Implantat geliefert:

- ⑤  Geräte-Name in die gewünschten Sprachen übersetzt
- ⑥  Produkt-Name
- ⑦  UDI-DI-Code (HRI)
- ⑧  Chargennummer/ Chargencode
- ⑨  UDI-Code (AIDC-Format)

Der Aufkleber mit den Produktinformationen für das bei der Operation verwendete Implantat ist in der Verpackung enthalten und muss wie unten gezeigt auf die leeren Seiten der Implantat-Karte angebracht werden:




Gemäß SPR 23.423.4 enthält die Patienteninformation alle der folgenden Angaben: (MDR Artikel 18 Text –Klausel 1 – (b), (c), (d)).

Die Patienteninformation sollte dem Patienten zusammen mit der Implantat-Karte ausgehändigt werden.

Bereits auf der Implantat-karte aufgedruckt:

- ④  Informations-Website des Herstellers
- ⑩  Name und Anschrift des Herstellers des implantierten Medizinprodukts

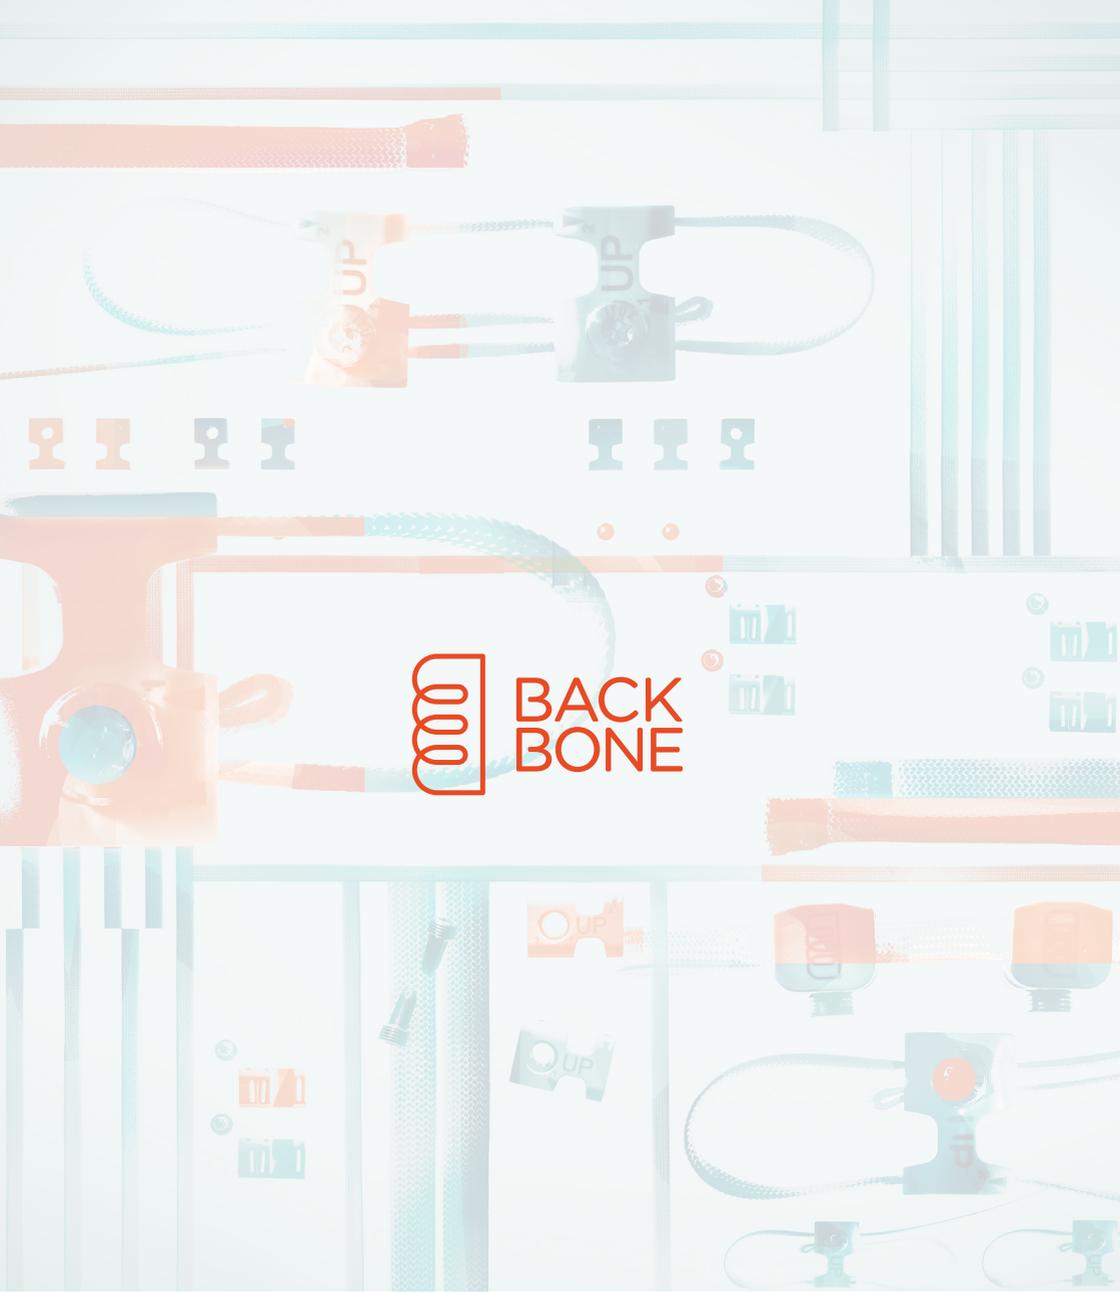

**BACK  
BONE**

NOT-LISA-PIC-DE-v02 27/05/2024

[WWW.BACKBONE.PRO/PATIENTS-INFORMATION](http://WWW.BACKBONE.PRO/PATIENTS-INFORMATION)